 **tu farmacia, fuente de salud**

A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO LOS VIALES DE INSULINA SERÁN DE 100 UI/ML

## Los farmacéuticos advertirán a los diabéticos sobre los cambios en la insulina

A nuestro país acuden cada año más de 40 millones de turistas. De ellos aproximadamente unos 200.000 son diabéticos y utilizan insulina en viales. Del mismo modo, muchos españoles viajan a otros países de Europa

y se ven obligados a adquirir dosis de insulina. Pero la que está a la venta en algunos países vecinos no es de 40 UI/ml como sí lo es la española. Con el fin de evitar los peligros que conlleva para la salud de estos enfermos

la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de Diabetes han pedido una unificación de los concentrados de insulina. En España el cambio se pondrá en marcha a principios de año.

### D.D. A Coruña

Desde el próximo 28 de febrero los diabéticos que empleen insulina en viales deberán entregar a su farmacéutico, en el momento de hacer uso de una nueva receta, todos los viales de insulina que usaban hasta el momento. También llevarán a su Centro Sanitario las jeringas graduadas para 40 UI/ml que no hayan sido usadas. La medida no afecta a aquellas personas con diabetes que utilizan sistemas de administración tipo pluma. De este modo los laboratorios farmacéuticos procederán a destruir los antiguos viales y jeringas y, a partir de la fecha arriba indicada, sólo se encontrarán a la venta los nuevos, cuya concentración es de 100 UI/ml.

Dado el peligro que entrañaría la desinformación en este tema diversos colectivos han emprendido campañas para divulgar el cambio. Los farmacéuticos advertirán a sus usuarios con problemas de

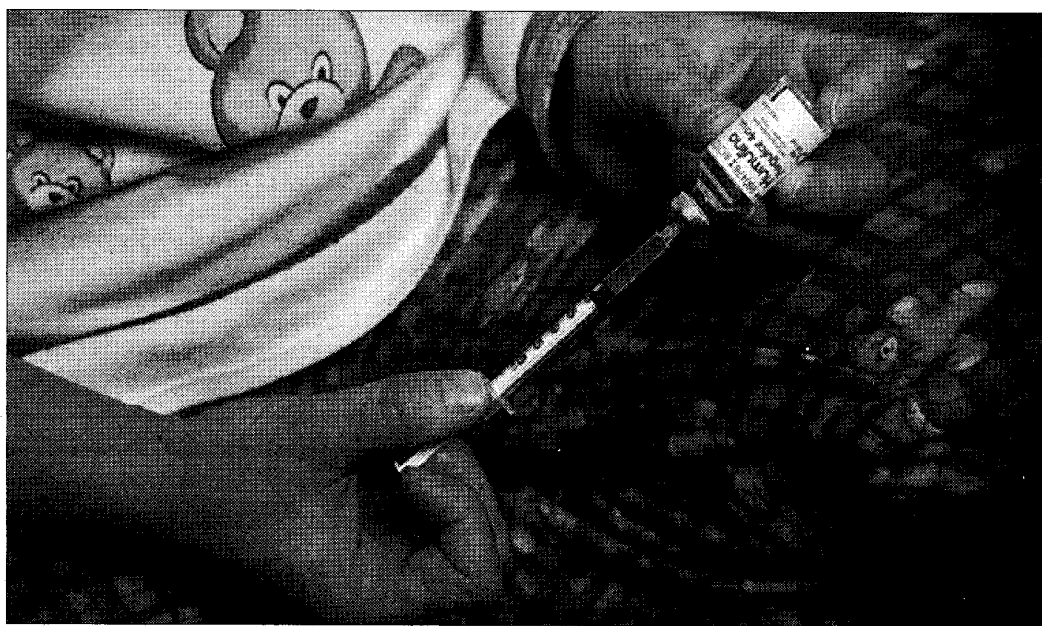


Foto: Cándido Díaz

diabetes a la hora de dispensar las nuevas dosis de metadona. También el Ministerio de Sanidad y Consumo ha editado un tríptico informativo que se está distribuyendo en farmacias y Centros de Salud. Los profesionales de la salud recomiendan al diabético que en ningún caso conserve a la

vez en su casa insulinas y jeringas antiguas y nuevas, ya que las nuevas dosis de insulina son más concentradas y las jeringas están graduadas especialmente para ellas. Emplear material adaptado a 40 UI/ml para las nuevas insulinas de 100 UI/ml implicaría para el diabético riesgo de padecer

una hiperglucemia.

El motivo del cambio es adaptar la concentración de nuestras dosis de insulina a las del resto de los países europeos. Esto facilitará notablemente las cosas a los pacientes diabéticos que viajen a otros países o a los europeos que viajen a España.